



ERP

Moduł WMS | Składanie zapotrzebowania

Instrukcja



LOGOWANIE

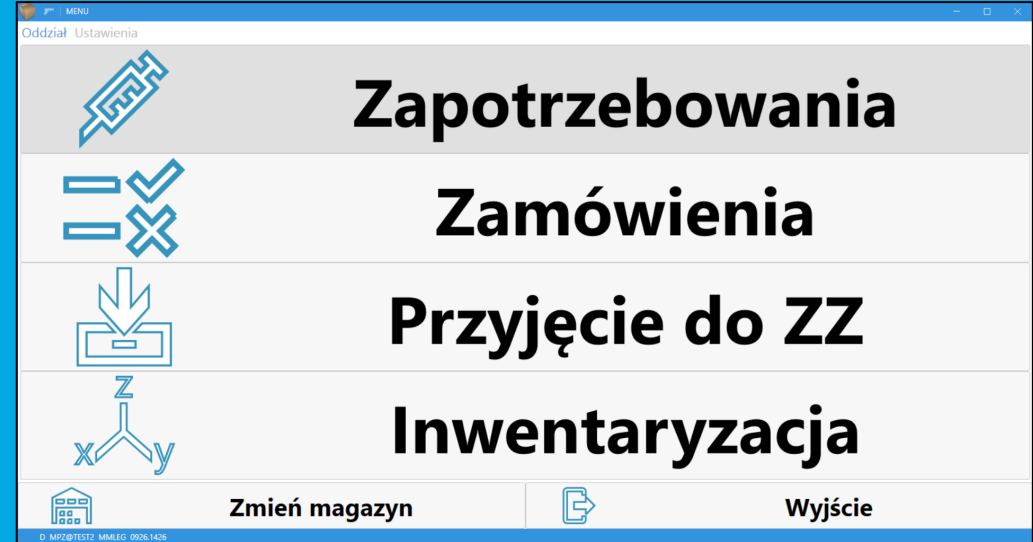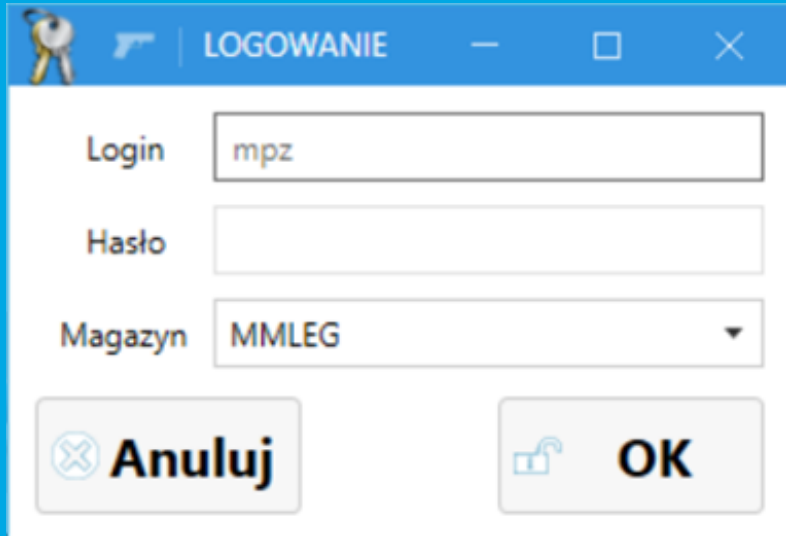

Widok po zalogowaniu


Login: pierwsza litera imienia, pierwsza i ostatnia litera nazwiska
(np. Michał Nowak – MNK)

Hasło:

Magazyn: na podstawie loginu magazyn zostanie wskazany automatycznie.


W przypadku zarządzania dwoma magazynami pojawi się rozwijana lista z możliwością wyboru.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

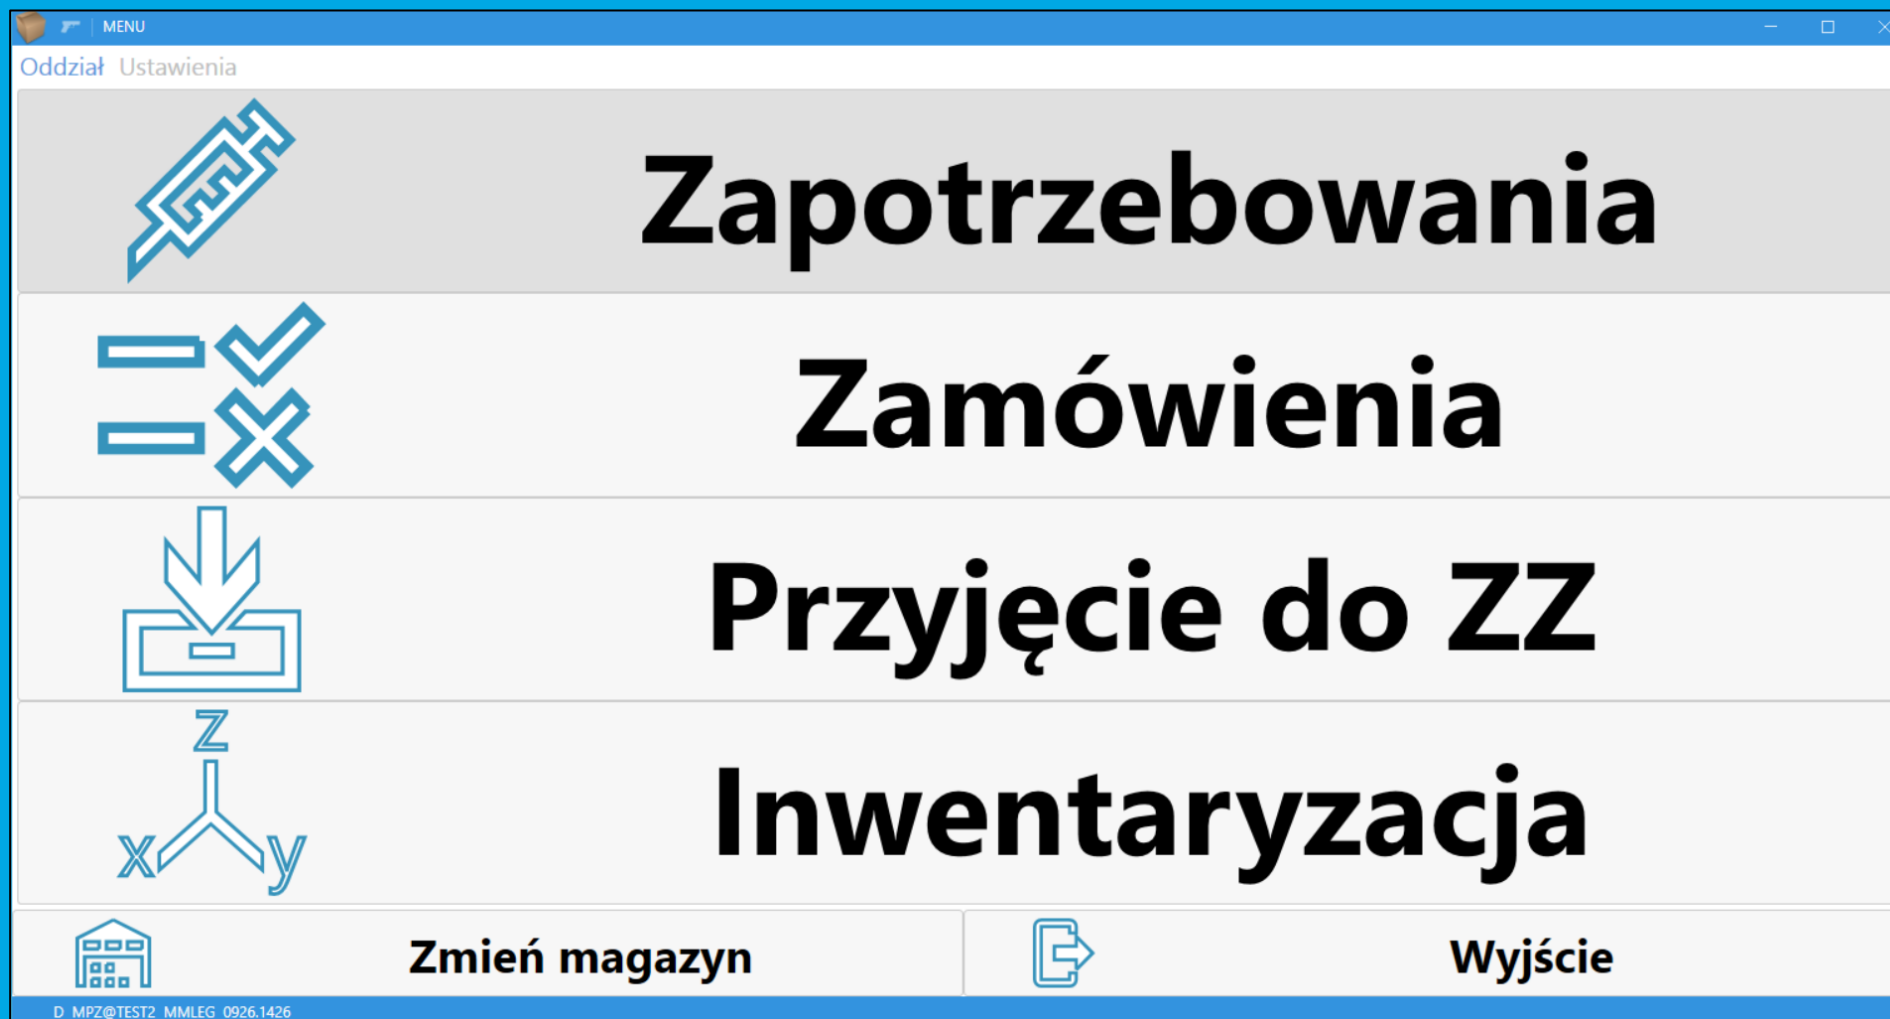

Klikamy w zakładkę „Zapotrzebowania”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

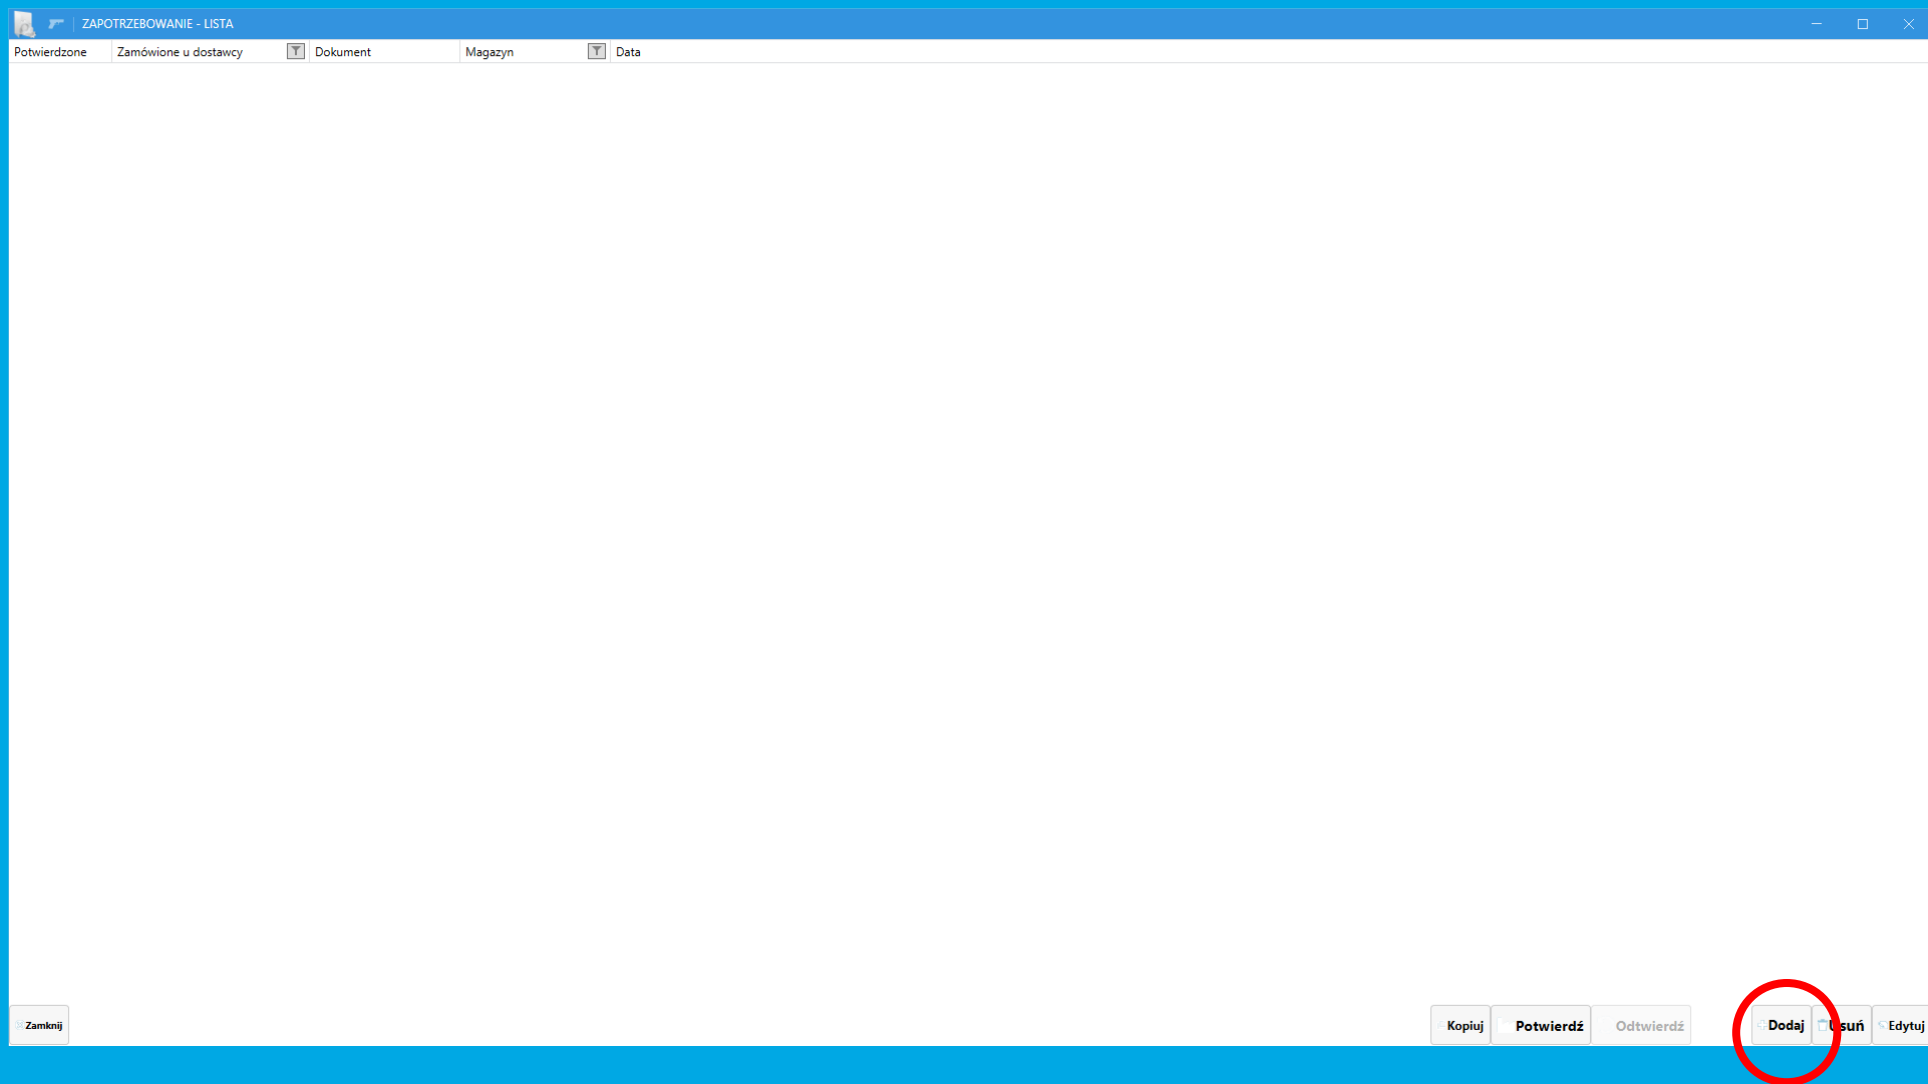

Klikamy przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu ekranu.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA

Ogólne **Elementy**

DOKUMENT 3/10/2023/MMLEG

Data 2023-10-16

Magazyn Legnica

Data potwierdz

Ope potwierdz

Data zam. u dostawcy

Ope zamawiający

Opis

Wyświetli się okno z otwartą zakładką „Ogólne”.
Aby dodać zapotrzebowanie klikamy na zakładkę „Elementy”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA

Ogólne Elementy

Towar Kod	Towar Nazwa	Potwierdź zero	Ilość sug	Ilość zam	Jm	Wymagany
-----------	-------------	----------------	-----------	-----------	----	----------

Zamknij

Podgląd towaru + Dodaj wymagane Dodaj Usuń Zapisz

Jeżeli jest to nasze pierwsze zamówienie w miesiącu, musimy zamówić towary wymagane klikając przycisk „Dodaj wymagane”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA						
Ogólne Elementy						
Towar Kod	Towar Nazwa	Ilość sug	Ilość zam	Otwierdz zero	Jm	Wymagany
70110	BICART 650 G GAMBRO	0	0	☐	szt.	☒
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605571	Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
1610	Chemisept HF 1 L	0	0	☐	szt.	☒
1618	Dializator FX 10	0	0	☐	szt.	☒
1564	Dializator FX 100 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1563	Dializator FX 60 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1617	Dializator FX 8	0	0	☐	szt.	☒
7346	Fartuch foliowy 100 szt/opk ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
467	Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR	0	0	☐	szt.	☒
55	Heparinum WZF 25 000 J.M/5ml * 10 fiol.	0	0	☐	fiol	☒
7358	IGŁA 1.2*30 18 G DO POBIERANIA LEKÓW ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
7042	Igła dializacyjna F 14 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7043	Igła dializacyjna F 14A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
608	Igła dializacyjna F 15 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
607	Igła dializacyjna F 15A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
610	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7299	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
609	Igła dializacyjna F 16A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
7301	Igła dializacyjna F 16A G Venous dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
612	Igła dializacyjna F 17 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
611	Igła dializacyjna F 17A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
6966	Intra Lock 4 % Citrate 10x5 ml	0	0	☐	amp	☒

Podgląd towaru + Dodaj wymagane Dodaj Usuń

Zamknij Zapisz

Pojawi się lista towarów do zamówienia. W polu „Ilość zam” wpisujemy ilości, które chcemy zamówić.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

Ogólne Elementy					
Towar Kod	Towar Nazwa	Potwierdź zero	Ilość sug	Ilość zam	Jm
607	Igła dializacyjna F 15A G Venous	☒	0		0 szt.
610	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial	☒	0		0 szt.
7299	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial dł. 20 mm	☐	0		100 szt.
609	Igła dializacyjna F 16A G Venous	☐	0		200 szt.
7301	Igła dializacyjna F 16A G Venous dł. 20 mm	☒	0		0 szt.
612	Igła dializacyjna F 17 AS G Arterial	☒	0		0 szt.
611	Igła dializacyjna F 17A G Venous	☒	0		0 szt.

Jeżeli nie chcemy towaru wymaganego, musimy zaznaczyć „Potwierdź zero” lewym przyciskiem myszy lub używając spacji + strzałki w dół.

UWAGA: Gdy wpisujemy ilość towaru do zamówienia i jednocześnie potwierdzimy zero, wszystkie podane ilości zostaną wyzerowane!

ZAPOTRZEBOWANIE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA

Ogólne Elementy

Towar Kod	Towar Nazwa	Ilość sug	Ilość zam	Potwierdź zero	Jm	Wymagany
70110	BICART 650 G GAMBRO	0	0	☐	szt.	☒
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605571	Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
1610	Chemisept HF 1 L	0	0	☐	szt.	☒
1618	Dializator FX 10	0	0	☐	szt.	☒
1564	Dializator FX 100 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1563	Dializator FX 60 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1617	Dializator FX 8	0	0	☐	szt.	☒
7346	Fartuch foliowy 100 szt/opk ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
467	Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR	0	0	☐	szt.	☒
55	Heparinum WZF 25 000 J.M/5ml * 10 fiol.	0	0	☐	fiol.	☒
7358	Igła 1.2*30 18 G DO POBIERANIA LEKÓW ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
7042	Igła dializacyjna F 14 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7043	Igła dializacyjna F 14A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
608	Igła dializacyjna F 15 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
607	Igła dializacyjna F 15A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
610	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7299	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
609	Igła dializacyjna F 16A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
7301	Igła dializacyjna F 16A G Venous dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
612	Igła dializacyjna F 17 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
611	Igła dializacyjna F 17A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
6966	Intra Lock 4 % Citrate 10x5 ml	0	0	☐	amp	☒

Podgląd towaru **Dodaj wymagane** **Dodaj** **Usuń**

Zapisz

Podgląd towaru **Dodaj wymagane** **Dodaj** **Usuń**

Zapisz

Zamknij

Jeżeli chcemy dopisać towar, którego nie ma na liście, klikamy „Dodaj”.
Dodany towar pojawi się na dole listy.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

The screenshot displays a software interface for a main requisition. A search window titled "TOWARY - LISTA" is open, showing a list of products. The "Nazwa" column is highlighted with a red circle. The background shows a list of requisition items with columns for item name, quantity, and unit.

Kod	Nazwa	Nazwa1	Jm	Ean
DR_EL-157	FERRUM LK 100MG 30 TABL. DO ZUCIA		opk	
467	Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR		szt.	
7348	Filtr p/bakteryjny do AMBU ZARYS		szt.	
673	Filtr wody-BigBlue 10" 5 MIK		szt.	
DR_EL-159	FLAVAMED TABL. 0,03G 20 TABL.		opk	
DR_EL-160	FLEGAMINA SYROP 0,08G/100 ML 120 ML		szt.	
DR_EL-161	FLEGAMINA TABL. 8MG 20 TABL.		opk	
DR_EL-162	FLUCONAZOLE KAPS. 0,05G 14 KAPS.		opk	
6907	Folia wymienna do przyłbicy ZONA VISOR PRO		szt.	
DR_EL-165	FORTTRANS LZR. PROSZ. 4 SASZ. 74G		szt.	
DR_FR10	FRAXIPARINE MULTI 9500 5ml		amp	
70096	FRAXIPARINE MULTI INJ.47500JM/5ML 10 AMPw		amp	
DR_EL-170	FURAGINUM TABL. 0,05G 30 TABL.		opk	
DR_AV-192	FUROSEMID INJ 10MG/ML		amp	
7297	FUROSEMIDE KAL.ROZTW.DO WSTRZ.I INFUZ.0,0		amp	
65736	Furosemidum 10mg/ml 2ml 5amp.		amp	
542	Gensulin R inj.100j.m/1 ml 5 wkładów3 ml		fiol	
65978	Gentamycin inj. doz. dom. 80 mg/2ml 10 a		amp	
DR_EL-182	GLUCOSUM 20% 10ML		szt.	
70247	GLUCOSUM 20% 250ML		szt.	
292	Glucosum 20% 500 ml		szt.	
DR_EL-185	GLUCOSUM 40% INJ. 50 AMP. 10 ML		amp	
DR GLUC-40-10	GLUCOSUM 40% 10ML		szt.	

Buttons at the bottom of the search window: Zamknij, Wybierz, Podgląd towaru.

Buttons at the bottom of the main window: Podgląd towaru, Dodaj wymagane, Dodaj.

Aby wyszukać dany towar, najezzdzamy na pole „Nazwa”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

The image shows two overlapping windows from a medical supply management application. The background window is titled 'TOWARY - LISTA' and displays a list of medical supplies with columns for 'Kod' (Code), 'Nazwa' (Name), 'Jm' (Unit), and 'Ean'. The foreground window is titled 'ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA' and shows a detailed view of a specific item, 'PD PLASTER OMNIFIX', with its own list of related items. Both windows have a search filter dialog open, which is circled in red in the top window. The dialog has a 'Tekst:' field, a 'Nie' checkbox, and three radio buttons for 'Zaczyna się:' (Not selected), 'Zawiera:' (Selected), and 'Równa się:' (Not selected). The 'Zawiera' option is selected in both dialogs. The bottom window also has buttons for 'Zamknij' (Close), 'Wybierz' (Select), and 'Podgląd towaru' (View item).

Kod	Nazwa	Jm	Ean
66004	Cewnik stały MAXID 40/23 cm.		
65578	Cewnik stały MAXID 45cm/28cm		
70074	CEWNIK SPLIT CATH 14FRX28CM		
DR_2279	Cewnik permanentny Medtronic 23/40 cm		
70073	CEWNIK HEMO-CATH 13,5X24	szt.	
70072	CEWNIK HEMO-CATH 13,5X20	szt.	
328	Cewnik czasowy HaemoCat Signo 20cm	szt.	
363	Kwaśny skl. SW 381 A-10 litrów (K:3,00, Ca:1,50)	szt.	
6893	Kwaśny SW 475 A-10 litrów (K:3,00, Ca:1,25)1+44	szt.	
6892	Kwaśny SW 806 A-10 litrów (K:2,00, Ca:1,25)1+44	szt.	
6970	Kwaśny SW 820 A-10 litrów (K:2,00, Ca:1,75)1+44	szt.	
6971	Kwaśny SW 830 A-10 litrów (K:3,00, Ca:1,75)1+44	szt.	
6894	Kwaśny SW 840 A-10 litrów (K:4,00, Ca:1,25)1+44	szt.	
70129	Softpac G304 5,0 L (K:3,00, CA:1,50, G0)	szt.	
70124	Softpac G298 5,0 L (K:2,00, CA:1,25)	szt.	
627	Softpac C304 3,5 L (K:3,0, CA:1,50, G0)	szt.	
622	Softpac C250 3,5 L (K:2,50, CA:1,50)	szt.	
620	Softpac C206 3,5 L (K:2,00 CA:1,25, G0)	szt.	
614	Softpac C193 3,5 L (K:1,50 CA:1,25)	szt.	
70110	BICART 650 G GAMBRO	szt.	
65875	Sol card 650	szt.	
1619	Dializator F10 HPS	szt.	
1618	Dializator FX 10	szt.	
1564	Dializator FX 100 CLASSIX	szt.	
1563	Dializator FX 60 CLASSIX	szt.	
1617	Dializator FX 8	szt.	
7014	Dializator Polyflux 140 High, powierzchnia 1,4	szt.	
2914	Dializator Polyflux 140 Low, powierzchnia 1,4	szt.	
1236	Dializator Polyflux 170 Low, powierzchnia 1,7	szt.	
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	amp	
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.	amp	
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.	amp	
70041	NEORECORMON 3000JM/0,3ML AMP	amp	
DR_999113605571	Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.	amp	
168	Neorecormon 2000jm/0,3ml x6 amp-strz.	amp	
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	amp	

Kod	Nazwa	Jm	Ean
DR_1885	PD PLASTER OMNIFIX		
'396	Plaster 6x8 cm do venflonów ZARYS		
'204	PLASTER DERMAFOIL10CMX12CM jałowy ZARYS		
'624	PLASTER ELASTPORE + PAD 10 cm x 10 cm JAŁOWY		
'205	PLASTER ELASTPORE + PAD 10 cm x 10 cm JAŁOWY ZARYS		
'5657	PLASTER ELASTPORE 10 cm x 10 metrów	szt.	
'257	PLASTER ELASTPORE 15 cm x 10 metrów	szt.	
'397	PLASTER ELASTPORE 5cm x 7,2cm ZARYS	szt.	
'207	PLASTER ELASTPORE+PAD I.V. 6cm x 8cm jałowy ZARYS	szt.	
'0107	PLASTER GAMBRO XL 500 SZT/OPK	szt.	
'0108	PLASTER SOFTPORE 2,5CM X 9,15M	szt.	

Pojawi się lejek, w puste pole wpisujemy nazwę towaru.

Preferowana opcja filtra to „Zawiera”. Wybieramy dany towar, klikamy „OK” i wpisujemy ilość.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA

Ogólne Elementy

Towar Kod	Towar Nazwa	Ilość sug	Ilość zam	Potwierdź zero	Jm	Wymagany
7358	IGŁA 1.2*30 18 G DO POBIERANIA LEKÓW ZARYS	0	0	☒	szt.	☐
7286	Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe XL	0	0	☒	opk	☐
7215	Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe S	0	0	☒	opk	☐
1617	Dializator FX 8	0	0	☒	szt.	☐
6971	Kwaśny SW 830 A-10 litrów (K:3,00, Ca:1,75)1+44	0	0	☒	szt.	☐
1618	Dializator FX 10	0	0	☒	szt.	☐
6894	Kwaśny SW 840 A-10 litrów (K:4,00, Ca:1,25)1+44	0	0	☒	szt.	☐
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☒	amp	☐
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.					☐
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.					☐
DR_7210558	ZESTAW LINII DO HDF-ONLINE					☐
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.					☐
70145	PRZEŚCIERADŁO MEDYCZNE 250X80 A					☐
7401	Pojemnik na odp. med. 5l ZARYS					☐
7060	Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe					☐
7214	Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe					☐
70110	BICART 650 G GAMBRO					☐
7288	STRZYKAWKA 10ML ZARYS					☐
7304	STRZYKAWKA 20ML 3 CZĘŚCIOWA Lue					☐
7293	STRZYKAWKA 20ML ZARYS					☐
7290	STRZYKAWKA 5ML ZARYS					☐

Podano złą ilość DR_999113605570 Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.


OK

Po dodaniu wszystkich towarów i ich ilości, klikamy „Zapisz”.

Jeżeli pominęliśmy towar obowiązkowy, otrzymamy komunikat „Podano złą ilość”.


W takim wypadku klikamy „OK” i uzupełniamy brakującą ilość lub potwierdzamy zero.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

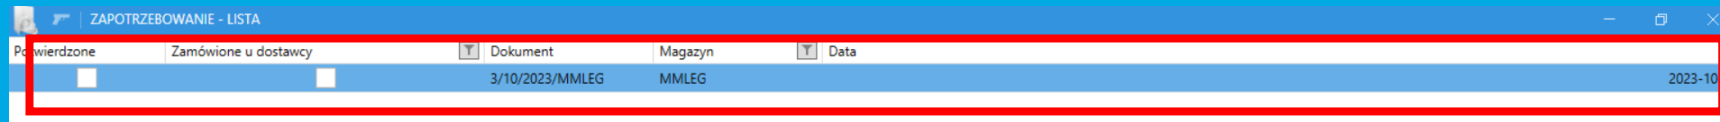


Potwierdzone	Zamówione u dostawcy	Dokument	Magazyn	Data
☐	☐	3/10/2023/MMLEG	MMLEG	2023-10-16

Po zapisaniu pojawi się zapotrzebowanie do potwierdzenia.

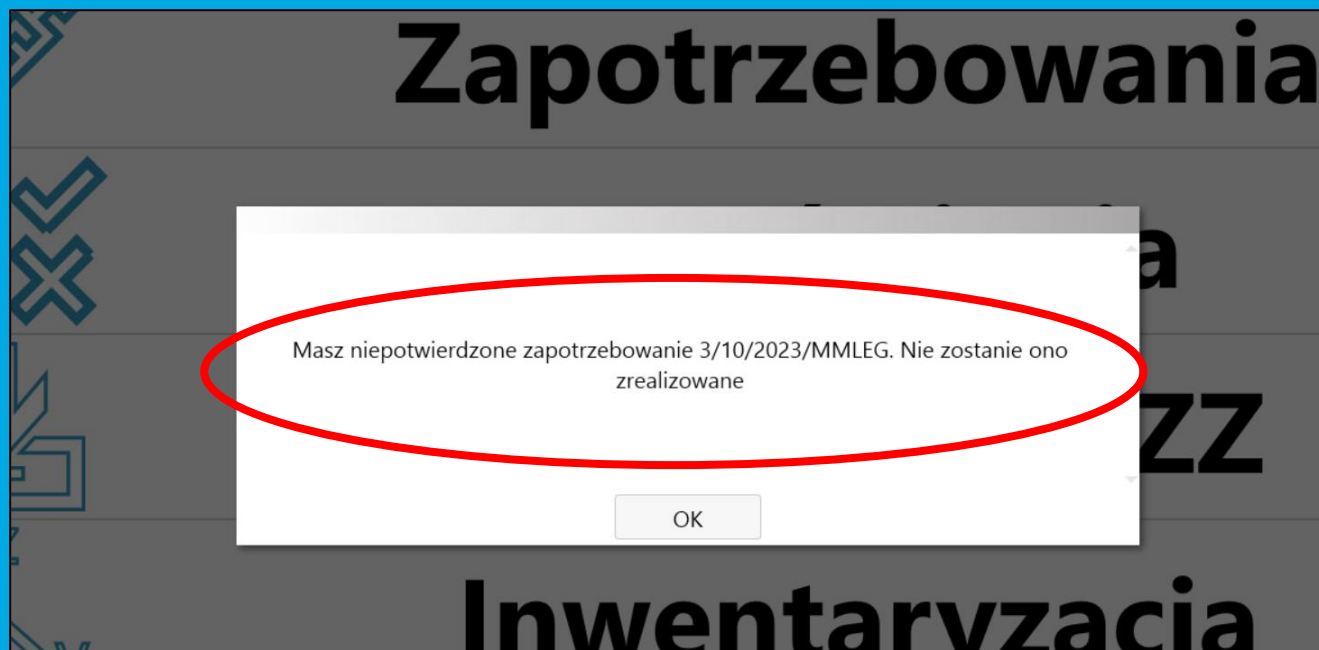


Jeżeli nie potwierdzimy zapotrzebowania, przy wyjściu z programu wyświetli się komunikat:
„Masz niepotwierdzone zapotrzebowanie. Nie zostanie ono zrealizowane”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

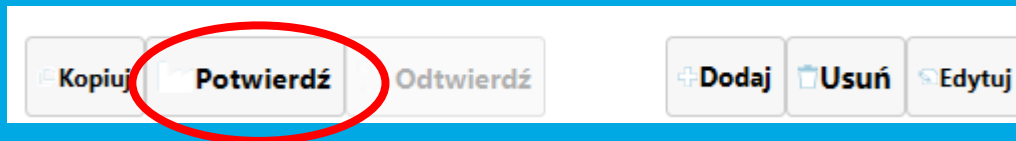


Zapotrzebowanie można edytować lub potwierdzić do realizacji.
Jeśli nie ma potrzeby edycji, w prawym dolnym rogu klikamy „Potwierdź”.

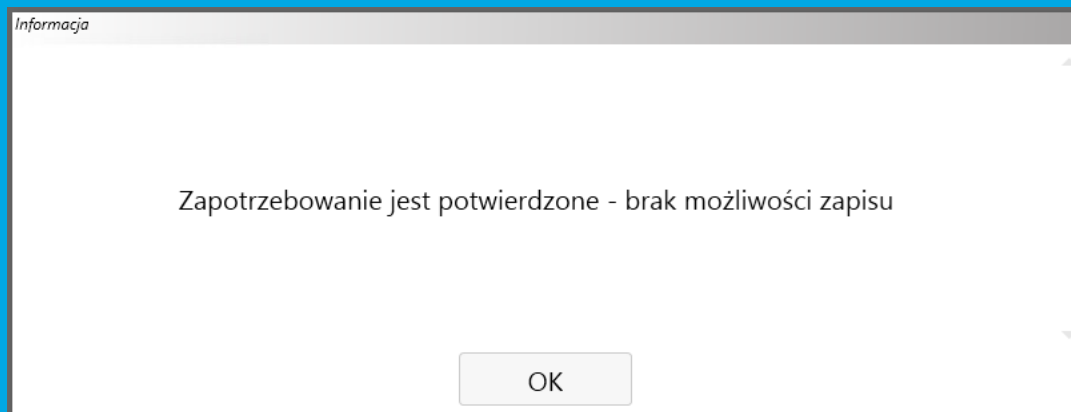

Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma już możliwości jego edycji.
Dodatkowy towar możemy domówić w nowym zapotrzebowaniu.

Jeśli istnieje potrzeba edycji potwierdzonego zapotrzebowania, prosimy
o kontakt z działem zakupów na adres e-mail: PL_ZAKUPY@DAVITA.COM

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

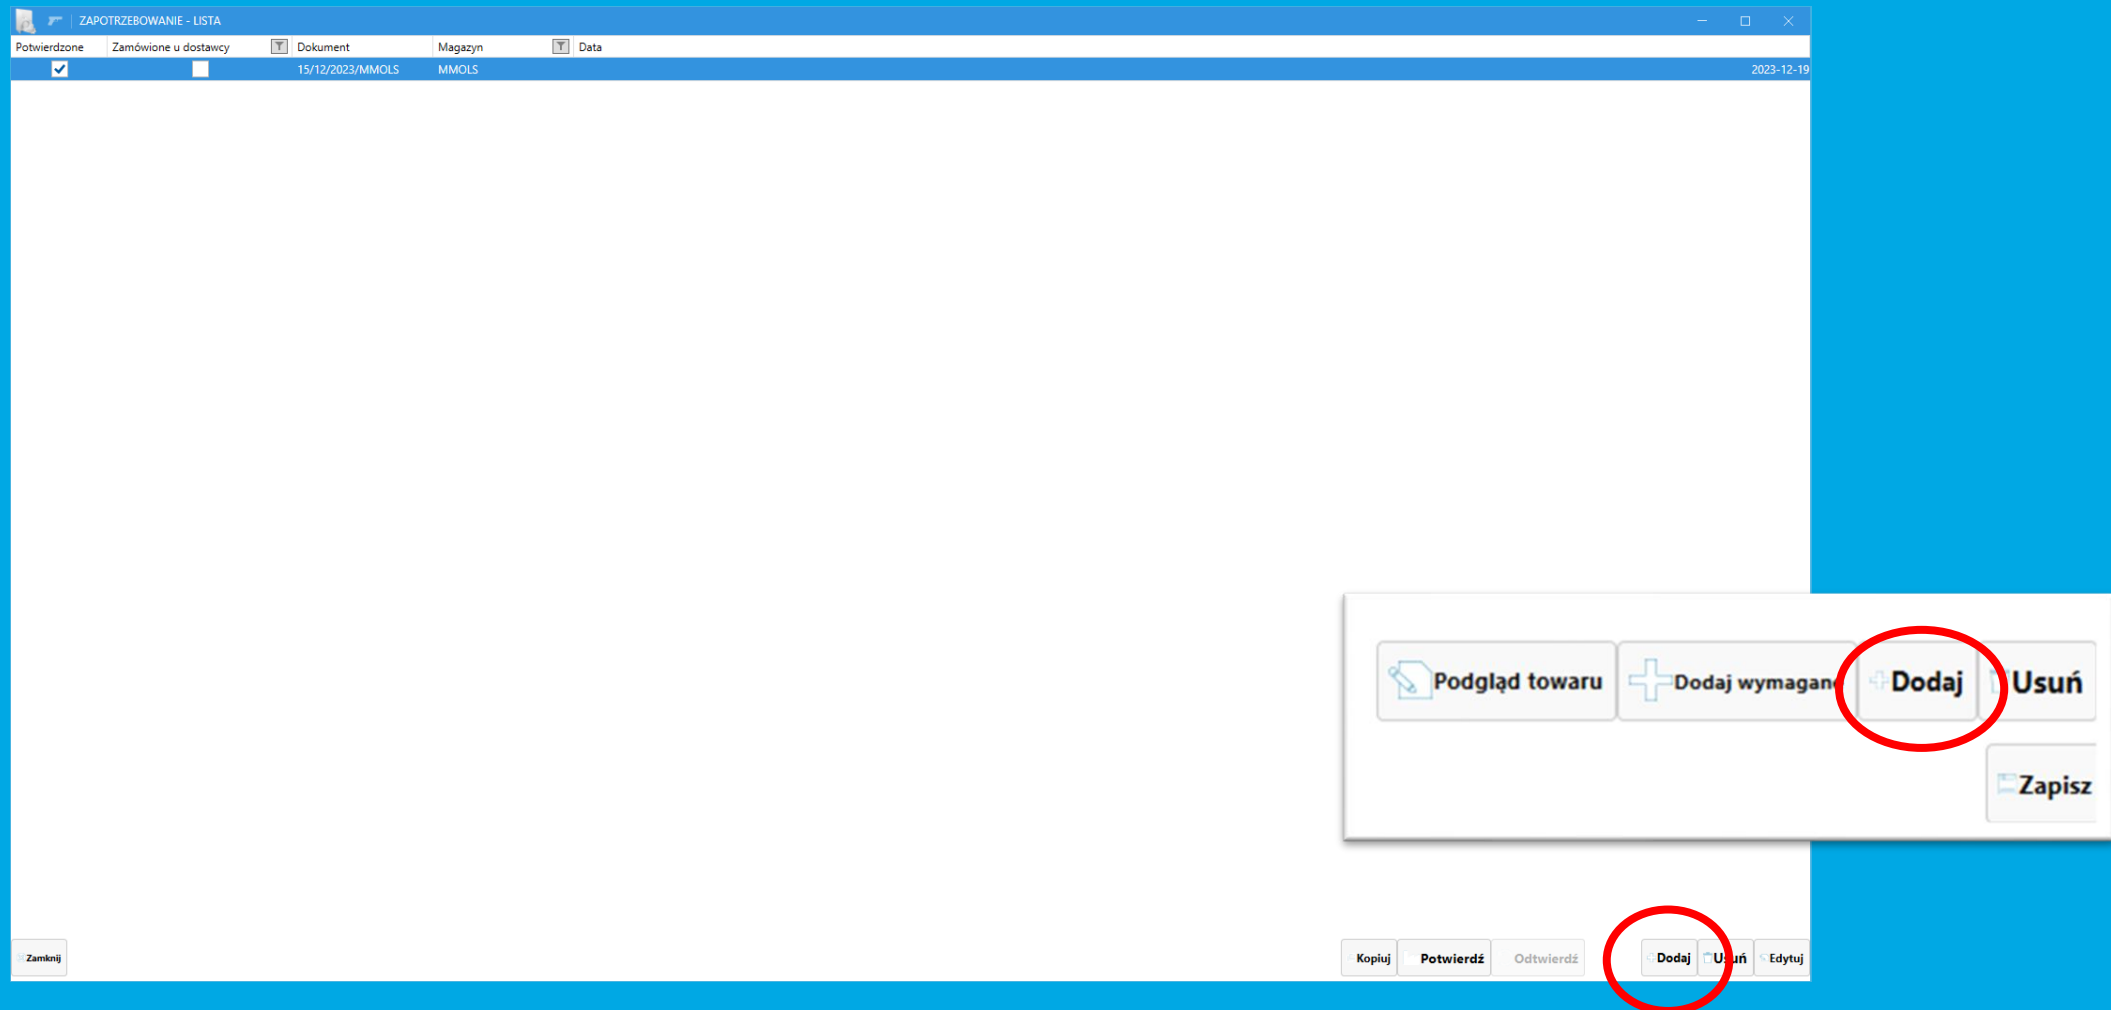

Klikamy przycisk „Dodaj”. Pojawi się okno z nowym zapotrzebowaniem.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE




Lista wysłanych przez dział zakupów zapotrzebowań do dostawców widoczna jest w zakładce „Zamówienia”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ELEMENTY ZAMÓWIEŃ - LISTA						
Kontrahent	Dokument	Ilość	Ilość zamówiona	Jm	Kod	Nazwa
ZARYS	ZZ-2023/10/10	99.00	99.00 szt.	7288		STRZYKAWKA 10ML ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	1300.00	1300.00 szt.	7304		STRZYKAWKA 20ML 3 CZESCIOWA LuerLock dicoNEX ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	99.00	99.00 szt.	7293		STRZYKAWKA 20ML ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	99.00	99.00 szt.	7290		STRZYKAWKA 5ML ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	1300.00	1300.00 szt.	7367		KORECZKI TYP LUER-LOCK ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	50.00	50.00 szt.	7401		Pojemnik na odp. med. 5l ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	2600.00	2600.00 szt.	7346		Fartuch foliowy 100 szt/opk ZARYS
ZARYS	ZZ-2023/10/10	100.00	100.00 opk	7060		Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe L
ZARYS	ZZ-2023/10/10	50.00	50.00 opk	7214		Rękawice easyCARE nitrylowe bezpudrowe M
ZARYS	ZZ-2023/10/10	2600.00	2600.00 szt.	7315		MASKA 3W z gumką ZARYS
D00864	ZZ-2023/10/11	50.00	50.00 szt.	1610		Chemisept HF 1 L
BAXTER POLSKA SP. Z	ZZ-2023/10/3	1299.00	1299.00 szt.	1666		Linia krwi NOVALINE BL 31 R + Kolec Spike
BAXTER POLSKA SP. Z	ZZ-2023/10/3	1300.00	1300.00 szt.	70110		BICART 650 G GAMBRO
BAXTER POLSKA SP. Z	ZZ-2023/10/3	500.00	500.00 szt.	608		Igła dializacyjna F 15 AS G Arterial
BAXTER POLSKA SP. Z	ZZ-2023/10/3	500.00	500.00 szt.	607		Igła dializacyjna F 15A G Venous
BAXTER POLSKA SP. Z	ZZ-2023/10/3	1500.00	1500.00 szt.	70013		NATRIUM CHLORATUM 0,9% 1000ML
AESCLAP CHIFA	ZZ-2023/10/4	200.00	200.00 szt.	6893		Kwaśny SW 475 A-10 litrów (K:3,00, Ca:1,25)1+44
AESCLAP CHIFA	ZZ-2023/10/4	200.00	200.00 szt.	6892		Kwaśny SW 806 A-10 litrów (K:2,00, Ca:1,25)1+44
AESCLAP CHIFA	ZZ-2023/10/4	100.00	100.00 szt.	6970		Kwaśny SW 820 A-10 litrów (K:2,00, Ca:1,75)1+44
AESCLAP CHIFA	ZZ-2023/10/4	5.00	5.00 szt.	467		Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	299.00	299.00 szt.	1564		Dializator FX 100 CLASSIX
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	999.00	999.00 szt.	1563		Dializator FX 60 CLASSIX
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	500.00	500.00 szt.	608		Igła dializacyjna F 15 AS G Arterial
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	500.00	500.00 szt.	607		Igła dializacyjna F 15A G Venous
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	299.00	299.00 amp	6966		Intra Lock 4 % Citrate 10x5 ml
FRESENIUS MEDICAL	ZZ-2023/10/5	1300.00	1300.00 szt.	515		Kolec do nakłuwania - Spike
LEK SA	ZZ-2023/10/6	1000.00	1000.00 amp	DR_999113605571		Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.
ASCLEPIOS	ZZ-2023/10/7	312.00	312.00 fiol	55		Heparinum WZF 25 000 J.M/5ml * 10 fiol.
BATIST	ZZ-2023/10/8	300.00	300.00 szt.	7243		Zestaw do zmianv oatrunku cewnika SET 525


Wyświetla się lista wszystkich zamówionych towarów, numer dokumentu zamówienia, ilość produktów oraz nazwa kontrahenta.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

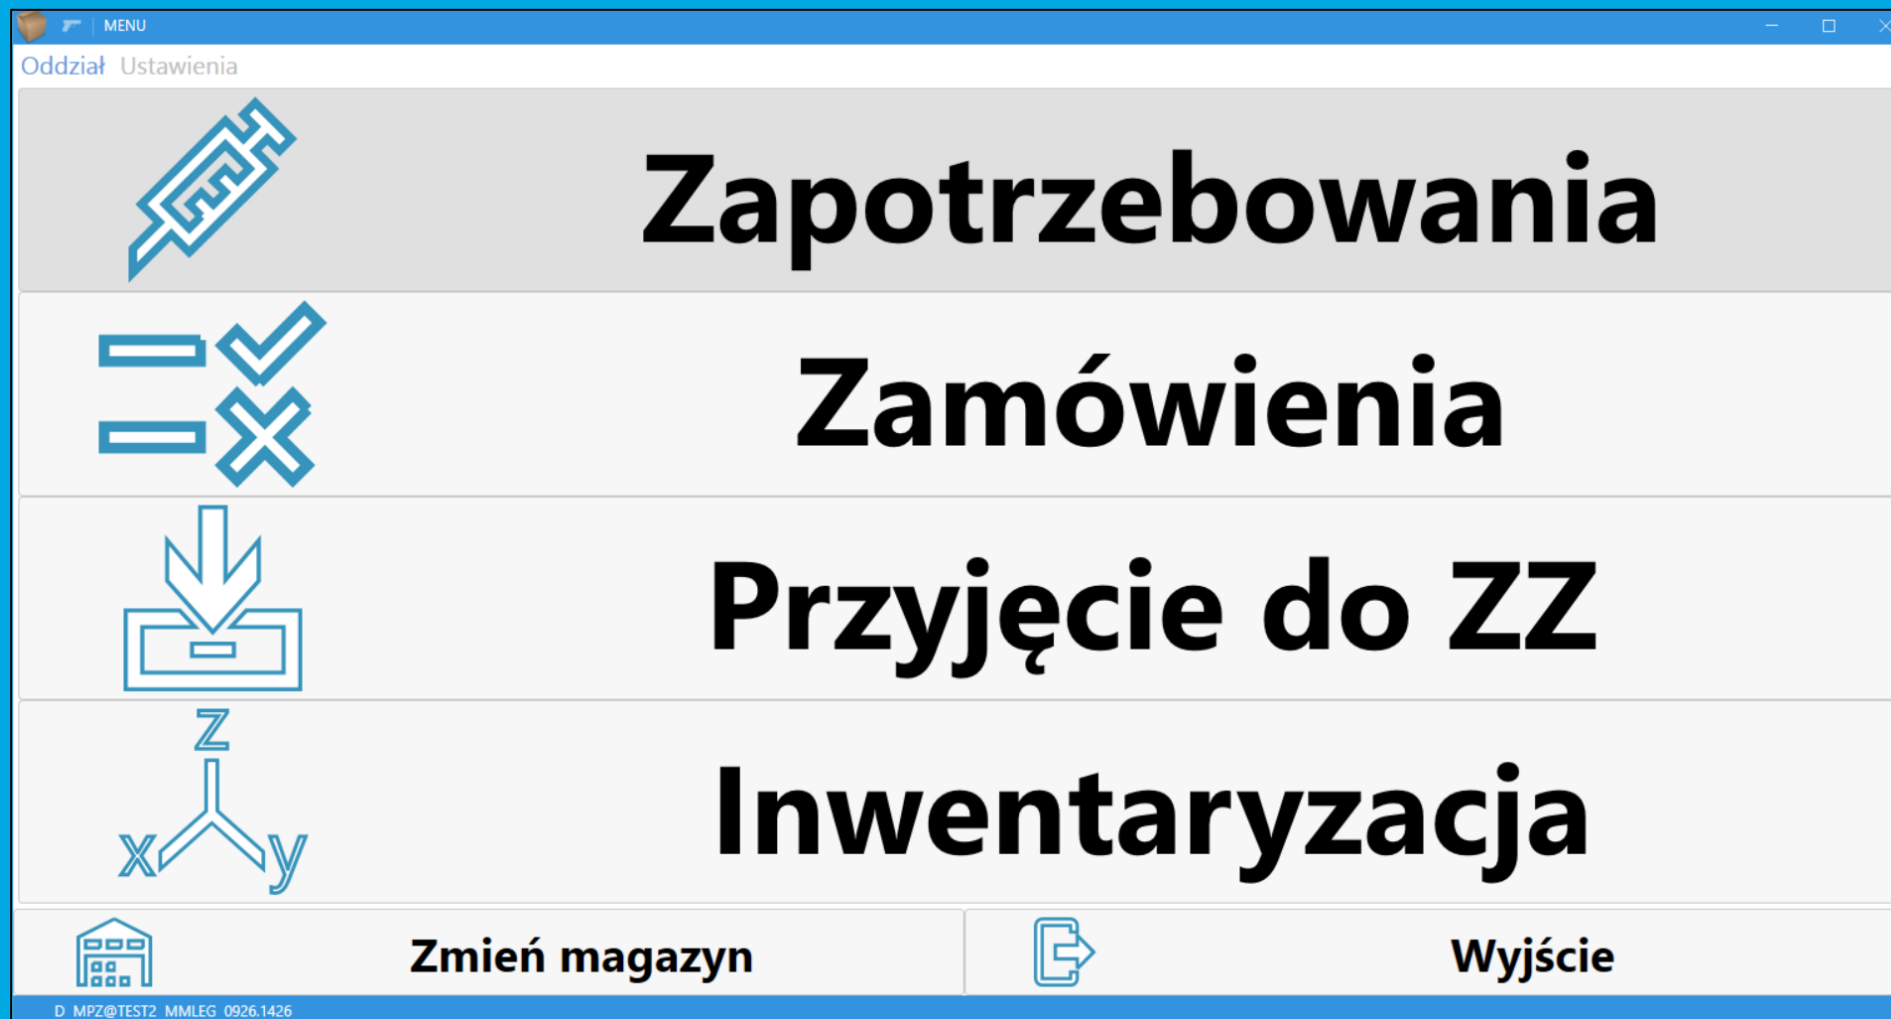

W aplikacji WMS istnieje możliwość skopiowania zamówienia.
Klikamy na zakładkę „Zapotrzebowania”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

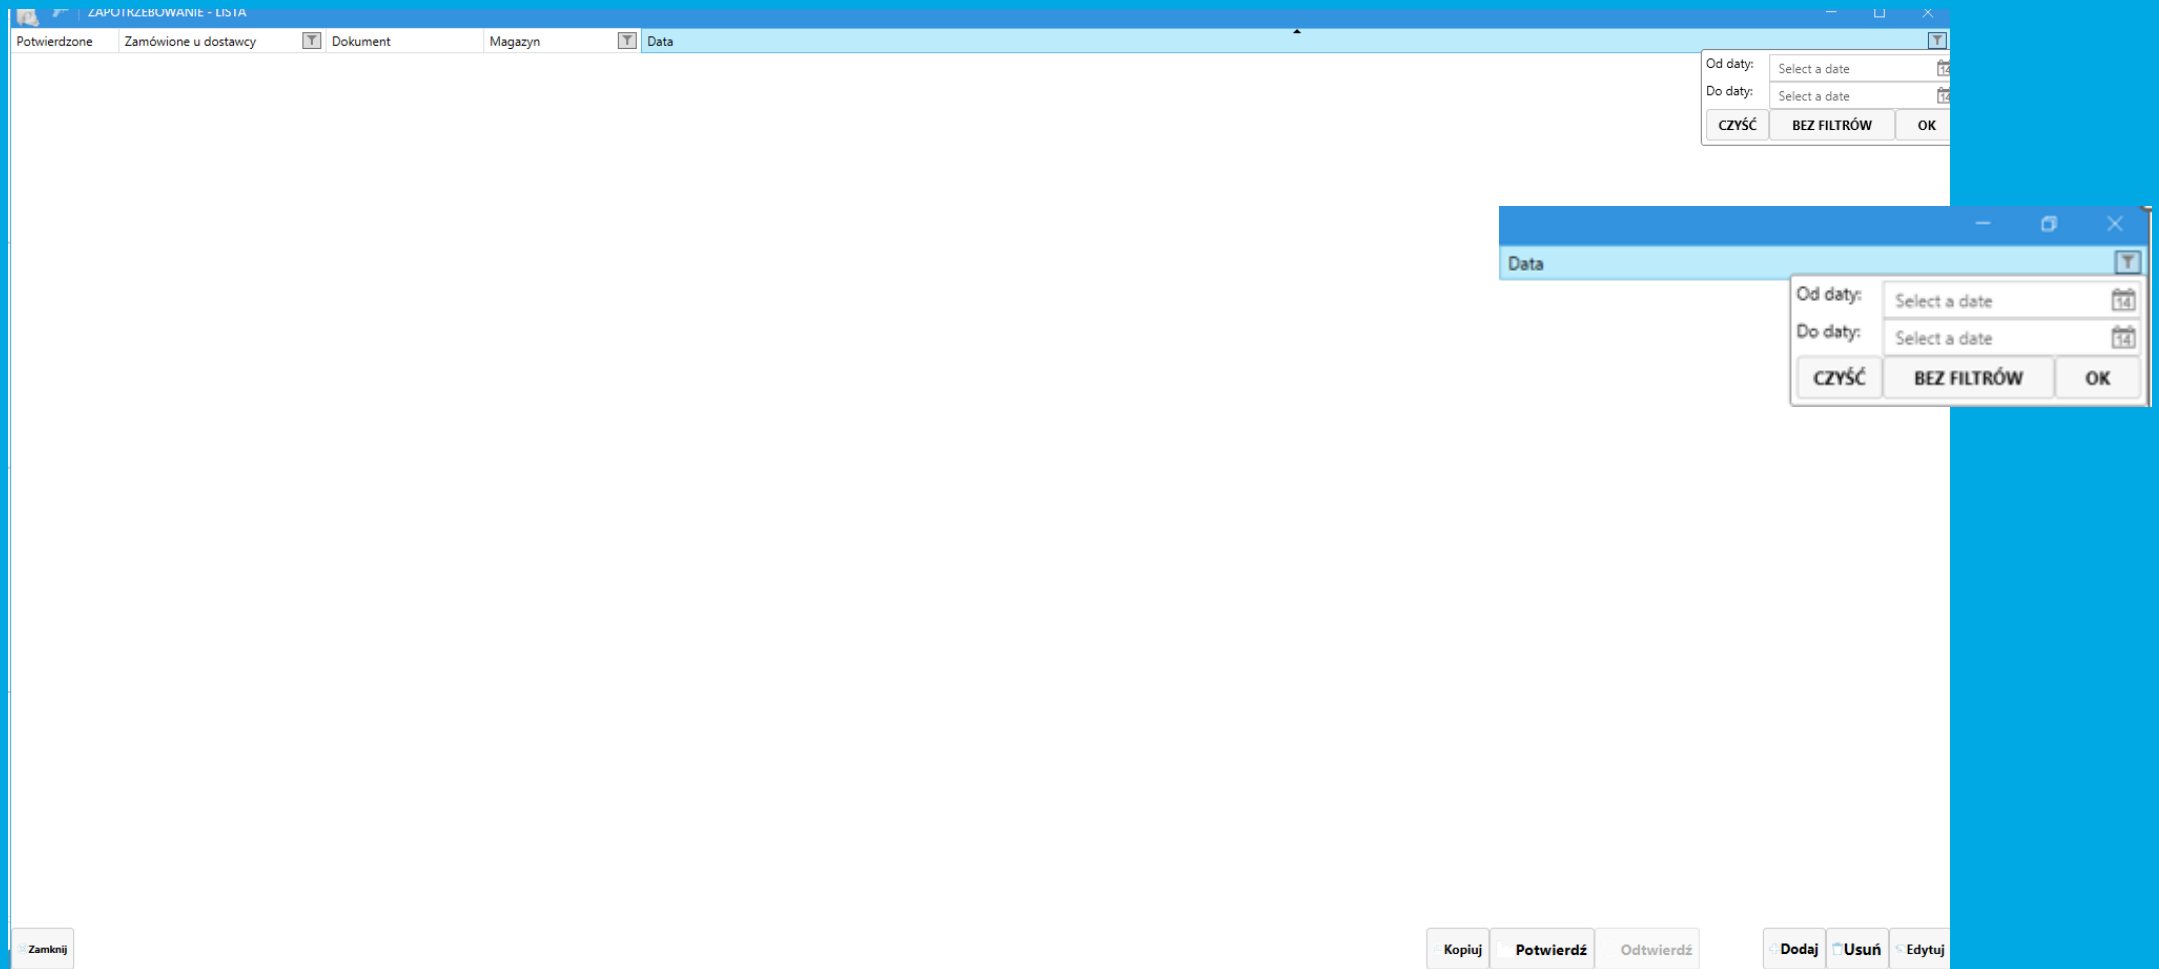

Aby zobaczyć listę historycznych zamówień najeżdżamy na pole „Data”.
Pojawi się lejek. Klikamy na lejek i klikamy przycisk „BEZ FILTRÓW”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - LISTA				
Potwierdzone	Zamówione u dostawcy	Dokument	Magazyn	Data
☒	☒	6/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-18
☒	☒	11/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-18
☒	☒	13/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-18
☒	☒	15/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-20
☒	☒	16/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-20
☒	☒	17/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-21
☒	☒	20/12/2023/MMLEG	MMLEG	2023-12-21

Pojawi się lista wszystkich historycznych zamówień.
Aby skopiować wybieramy dane zamówienie i klikamy „Kopiuj”.

ZAPOTRZEBOWANIE GŁÓWNE

ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA

Ogólne

Elementy

Towar Kod	Towar Nazwa	Potwierdź zero	Ilość sug	Ilość zam	Jm	Wymagany
70110	BICART 650 G GAMBRO	☒		0	0 szt.	☐
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	☒		0	0 amp	☐
DR_999113605571	Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.	☒		0	0 amp	☐
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.	☒		0	0 amp	☐
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.	☒		0	0 amp	☐
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	☒		0	0 amp	☐
1610	Chemisept HF 1 L	☒		0	0 szt.	☐
1618	Dializator FX 10	☒		0	0 szt.	☐
1564	Dializator FX 100 CLASSIX	☐		0	120 szt.	☐
1563	Dializator FX 60 CLASSIX	☒		0	0 szt.	☐
1617	Dializator FX 8	☐		0	100 szt.	☐
7346	Fartuch foliowy 100 szt/opk ZARYS	☒		0	0 szt.	☐
467	Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR	☒		0	0 szt.	☐
55	Heparinum WZF 25 000 J.M/5ml * 10 fiol.	☒		0	0 fiol.	☐
7358	IGLA 1,2*30 18 G DO POBIERANIA LEKÓW ZARYS	☒		0	0 szt.	☐
7042	Igla dializacyjna F 14 AS G Arterial	☐		0	100 szt.	☐
7043	Igla dializacyjna F 14A G Venous	☐		0	100 szt.	☐
608	Igla dializacyjna F 15 AS G Arterial	☒		0	0 szt.	☐
607	Igla dializacyjna F 15A G Venous	☒		0	0 szt.	☐
610	Igla dializacyjna F 16 AS G Arterial	☒		0	0 szt.	☐
7299	Igla dializacyjna F 16 AS G Arterial dk. 20 mm	☒		0	0 szt.	☐
609	Igla dializacyjna F 16A G Venous	☒		0	0 szt.	☐
7301	Igla dializacyjna F 16A G Venous dk. 20 mm	☒		0	0 szt.	☐
612	Igla dializacyjna F 17 AS G Arterial	☒		0	0 szt.	☐
611	Igla dializacyjna F 17A G Venous	☒		0	0 szt.	☐
6966	Intra Lock 4 % Citrate 10x5 ml	☐		0	100 amp	☐
515	Kolec do nakłuwania - Spike	☒		0	0 szt.	☐
7367	KORECZKI TYP LUER-LOCK ZARYS	☐		0	250 szt.	☐
6893	Kwaśny SW 475 A-10 litrów (K3,00, Ca:1,25)1+44	☐		0	200 szt.	☐
6892	Kwaśny SW 806 A-10 litrów (K2,00, Ca:1,25)1+44	☐		0	200 szt.	☐
6970	Kwaśny SW 820 A-10 litrów (K2,00, Ca:1,75)1+44	☒		0	0 szt.	☐
6971	Kwaśny SW 830 A-10 litrów (K3,00, Ca:1,75)1+44	☒		0	0 szt.	☐
6894	Kwaśny SW 840 A-10 litrów (K4,00, Ca:1,25)1+44	☒		0	0 szt.	☐
1666	Linia krwi NOVALINE BL 31 R + Kolec Spike	☐		0	216 szt.	☐

Zamknij

Podgląd towaru

+ Dodaj wymagane


Dodaj

☐ Usuń

Zapisz


Pojawi się okno z zamówieniem z wypełnionymi ilościami. Zamówienie można edytować. Działamy analogicznie jak przy składaniu zapotrzebowania.

ZAPOTRZEBOWANIE DODATKOWE / DOMÓWIENIE

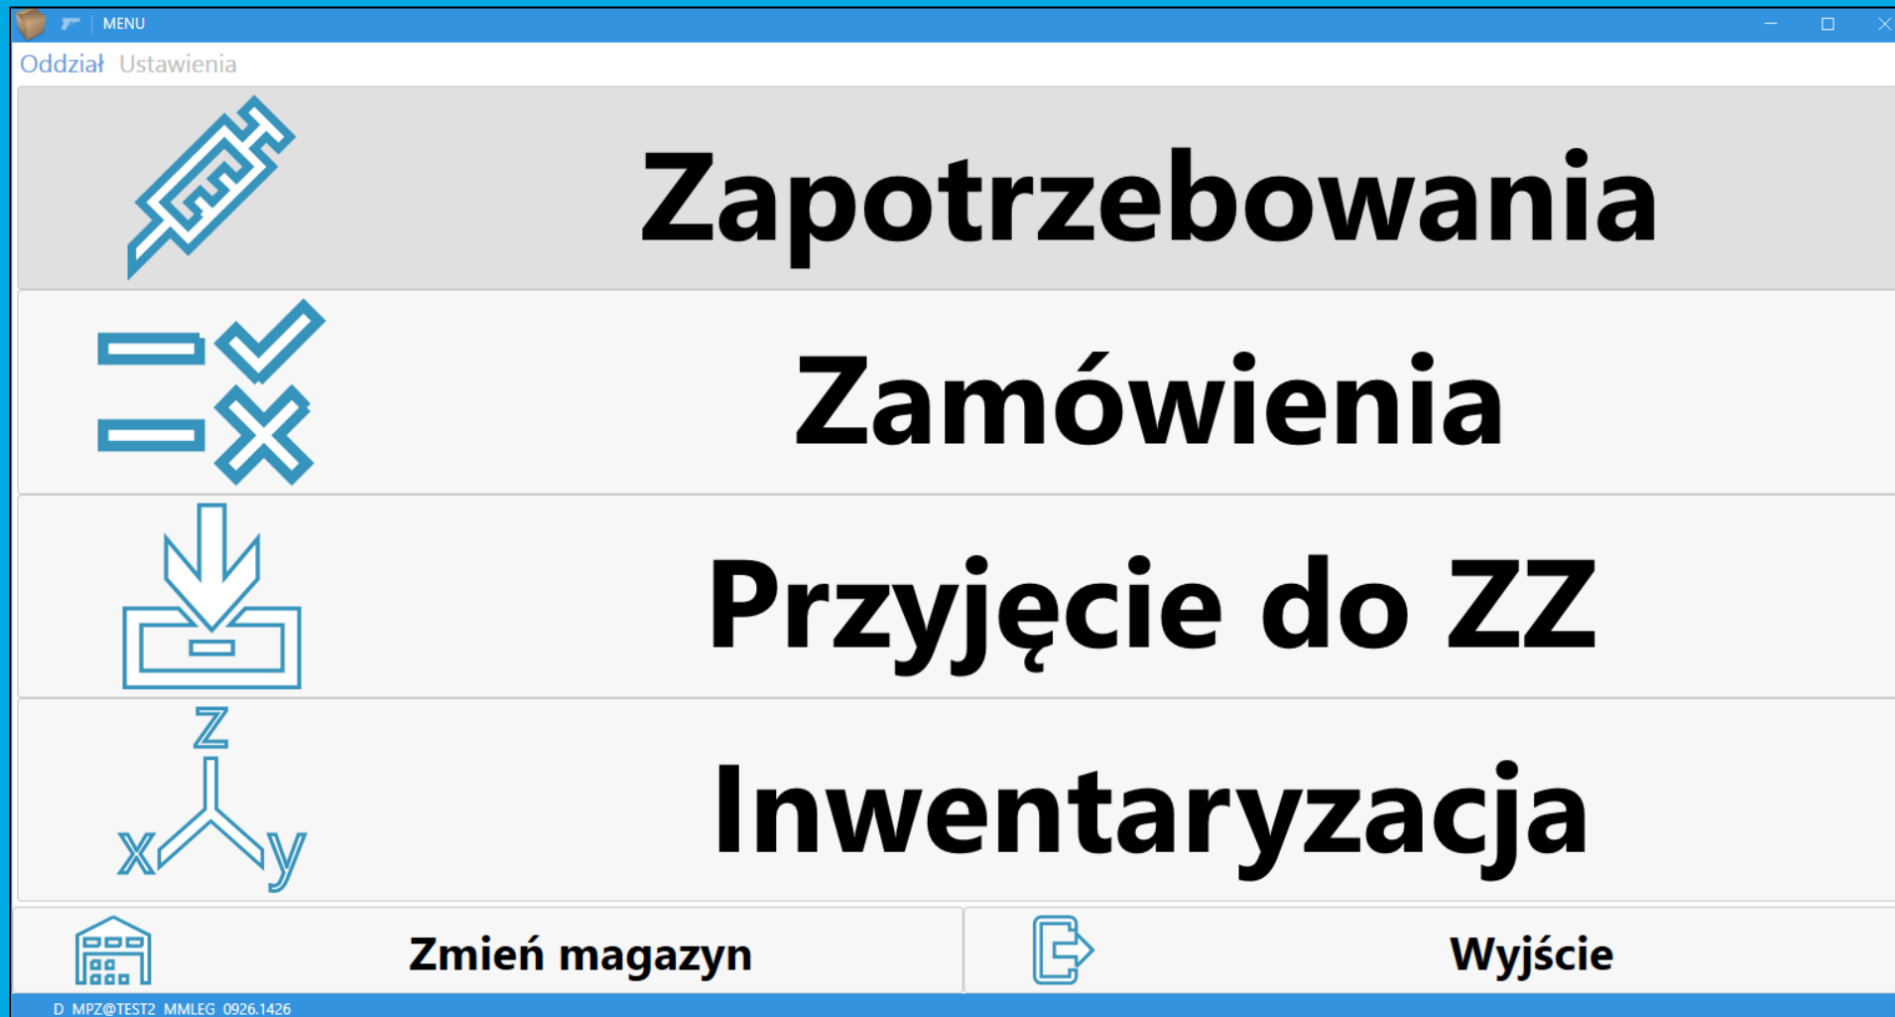

Klikamy w zakładkę „Zapotrzebowania”.

ZAPOTRZEBOWANIE DODATKOWE / DOMÓWIENIE

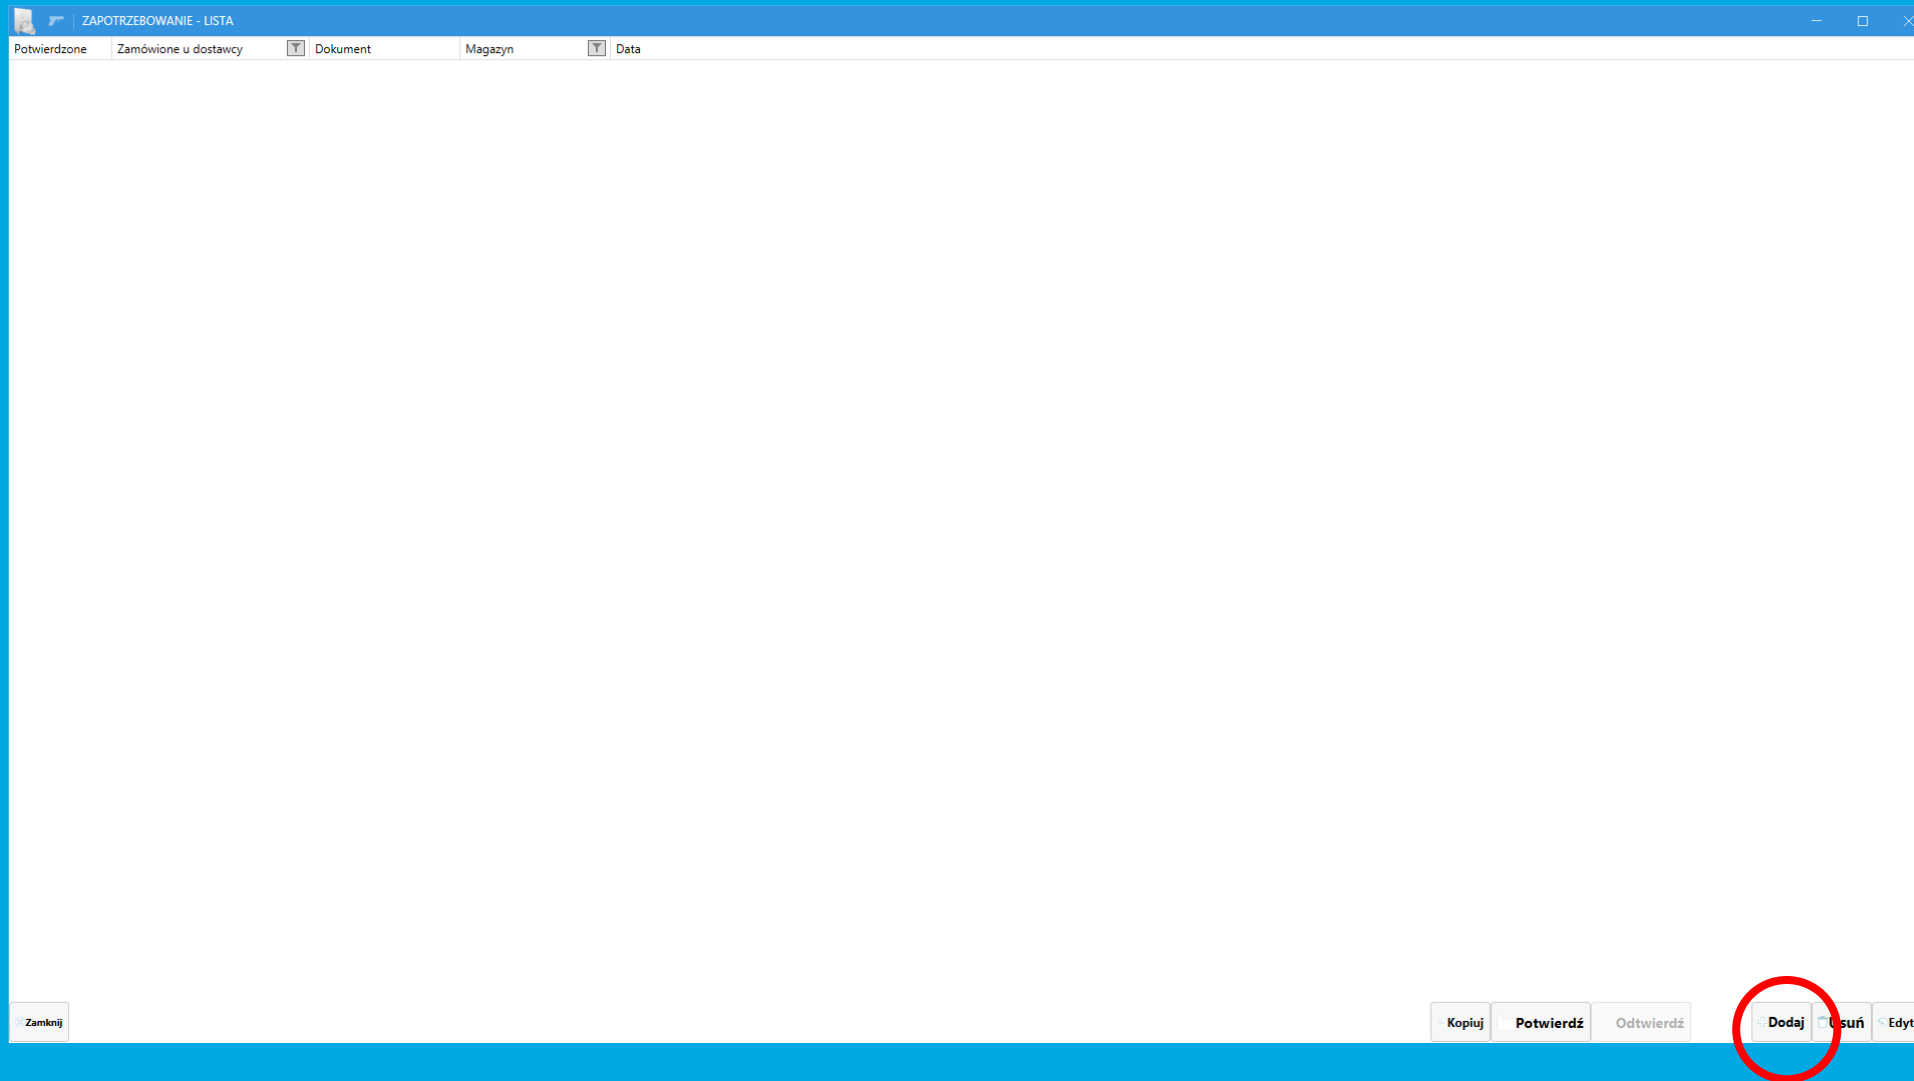

Klikamy przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu ekranu.

ZAPOTRZEBOWANIE DODATKOWE / DOMÓWIENIE

The screenshot shows a web application window titled "ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA". The left sidebar contains two tabs: "Ogólne" and "Elementy". The "Elementy" tab is selected and highlighted with a red circle. The main content area displays a form with the following fields:

DOKUMENT	3/10/2023/MMLEG
Data	2023-10-16
Magazyn	Legnica
Data potwierdz	
Ope potwierdz	
Data zam. u dostawcy	
Ope zamawiający	
Opis	

Wyświetli się okno z otwartą zakładką „Ogólne”.
Aby dodać zapotrzebowanie klikamy na zakładkę „Elementy”.

ZAPOTRZEBOWANIE DODATKOWE / DOMÓWIENIE

The screenshot displays a web application window titled "ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA". The window has a header bar with "Ogólne" and "Elementy" tabs. Below the header is a table with the following columns: "Towar Kod", "Towar Nazwa", "Potwierdź zero", "Ilość sug", "Ilość zam", "Jm", and "Wymagany". The table is currently empty. At the bottom right of the window, there are five buttons: "Podgląd towaru", "Dodaj wymagane", "Dodaj", "Usuń", and "Zapisz". At the bottom left, there is a "Zamknij" button.

Analogicznie jak przy składaniu zapotrzebowania głównego możemy dodać listę z towarami wymaganymi lub dodać wybrane towary używając przycisku „Dodaj”.

FUNKCJA DODATKOWA - PODGLĄD TOWARU

The screenshot displays a software window titled 'ZAPOTRZEBOWANIE - KARTA'. It features a table with columns: 'Towar Kod', 'Towar Nazwa', 'Ilość sug', 'Ilość zam', 'Potwierdź zero', 'Jm', and 'Wymagany'. The table lists various medical supplies, including BICART 650 G GAMBRO, Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk., and others. A red circle highlights the 'Podgląd towaru' button in the bottom right corner of the table. Another red circle highlights the 'Podgląd towaru' button in a separate window that appears to be a modal or tooltip, also with a red circle around it. The modal window also contains buttons for 'Dodaj wymagane', 'Dodaj', 'Usuń', and 'Zapisz'.

Towar Kod	Towar Nazwa	Ilość sug	Ilość zam	Potwierdź zero	Jm	Wymagany
70110	BICART 650 G GAMBRO	0	0	☐	szt.	☒
DR_999113605570	Binocrit 1000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605571	Binocrit 2000 j.m/ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
DR_999113605572	Binocrit 3000 j.m/0,3ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
2875	Binocrit 4000 j.m/0,4ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
7117	Binocrit 5000 j.m/0,5ml, 6 amp-strzyk.	0	0	☐	amp	☒
1610	Chemisept HF 1 L	0	0	☐	szt.	☒
1618	Dializator FX 10	0	0	☐	szt.	☒
1564	Dializator FX 100 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1563	Dializator FX 60 CLASSIX	0	0	☐	szt.	☒
1617	Dializator FX 8	0	0	☐	szt.	☒
7346	Fartuch foliowy 100 szt/opk ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
467	Filtr DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTR	0	0	☐	szt.	☒
55	Heparinum WZF 25 000 J.M/5ml * 10 fiol.	0	0	☐	fiol	☒
7358	IGŁA 1.2*30 18 G DO POBIERANIA LEKÓW ZARYS	0	0	☐	szt.	☒
7042	Igła dializacyjna F 14 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7043	Igła dializacyjna F 14A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
608	Igła dializacyjna F 15 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
607	Igła dializacyjna F 15A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
610	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
7299	Igła dializacyjna F 16 AS G Arterial dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
609	Igła dializacyjna F 16A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
7301	Igła dializacyjna F 16A G Venous dł. 20 mm	0	0	☐	szt.	☒
612	Igła dializacyjna F 17 AS G Arterial	0	0	☐	szt.	☒
611	Igła dializacyjna F 17A G Venous	0	0	☐	szt.	☒
6966	Intra Lock 4 % Citrate 10x5 ml	0	0	☐	amp	☒

Istnieje możliwość podglądu towaru (specyfikacja towaru).
W tym celu wybieramy dany towar i klikamy „Podgląd towaru”.

FUNKCJA DODATKOWA - PODGLĄD TOWARU

Karta towaru - do przeglądu (7541)

Ogólne Zasoby Jednostki, kody, VAT Kontrahenci MRP Opisy i tłumaczenia Załączniki

Kod 7541 **EAN**

Nazwa: Pakiet do dializy - AVF START/STOP SET

Dodatkowa nazwa:

Certyfikat:

Symbol:

SWW/PKWIU **Kod z Fpp:**

Producent

Marka:

☐ Edycja nazwy
☐ Archiwalny

Typ
☒ Towar
☐ Produkt
☐ Koszt
☐ Usługa

☐ Licencja
☐ Kaucja
☐ Bon

Stawka VAT zakupu: B 8,00%
Stawka VAT sprz.: B 8,00%

☐ Odwrotne obciążenie ☐ Limit O.O.
☐ Podzielona płatność (MPP)

Stawka cła: 0,00%
Stawka akcyzy: 0,00%


PCN
Kraj

Kod KGO:
Stawka KGO:

Kod odpadu:

Pojawi się okno z kartą towaru – do przeglądu.

FUNKCJA DODATKOWA - PODGLĄD TOWARU

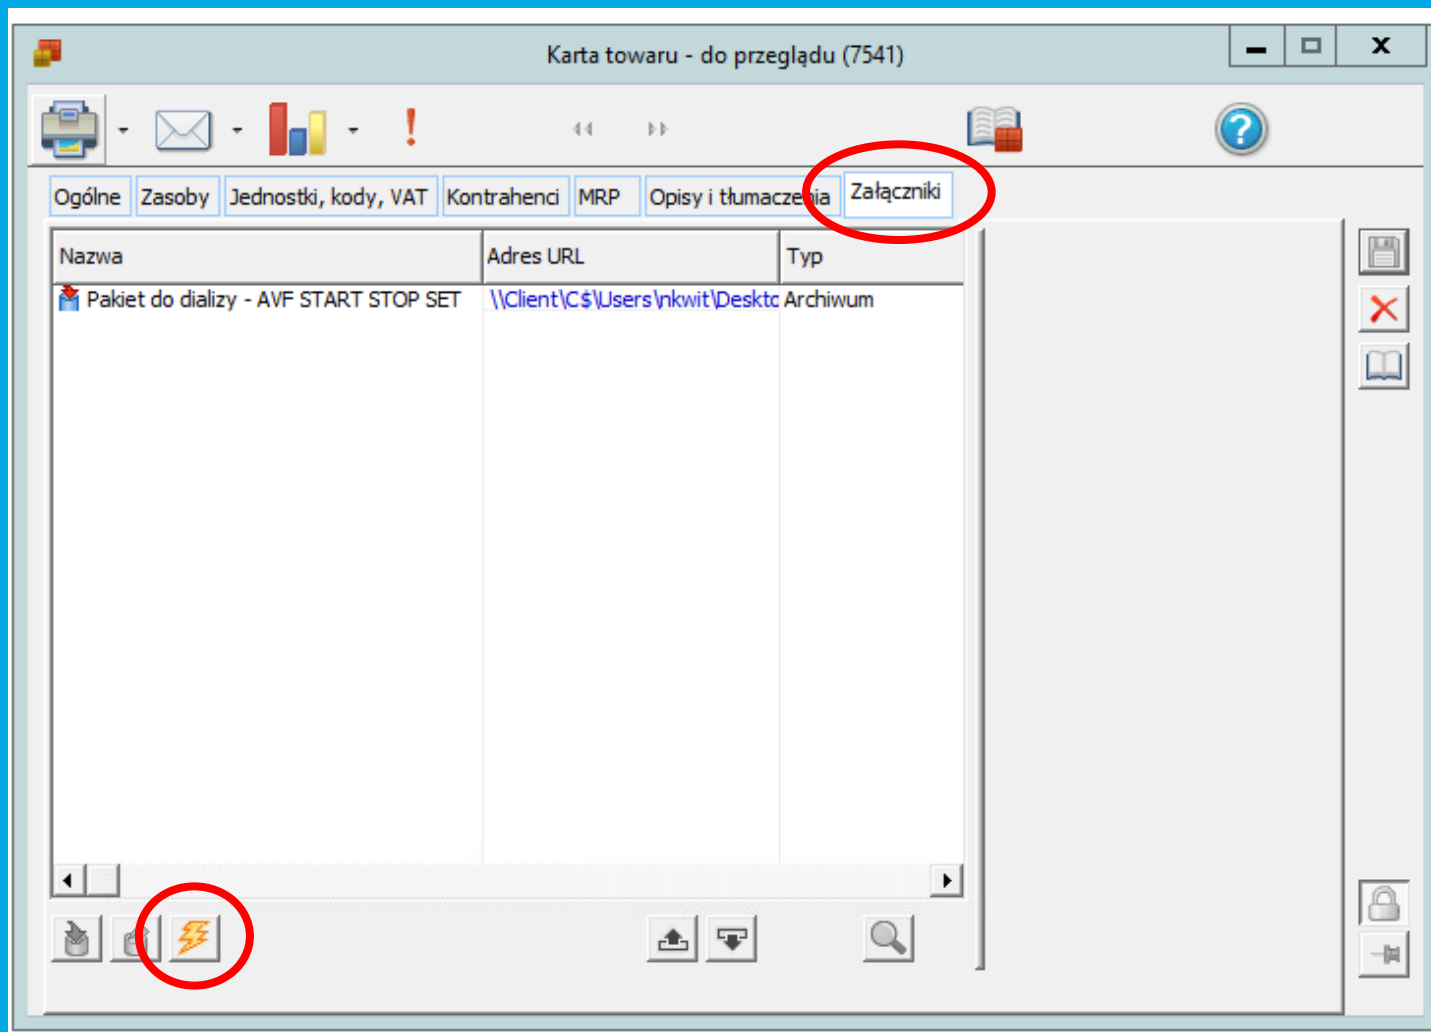

W zakładce „Załączniki” mogą się znajdować się pliki np. karta charakterystyki. Aby pobrać dokument, zaznaczamy go i klikamy na ikonkę z piorunem. Otworzy się plik, który można pobrać i zapisać na swoim komputerze.

Dziękujemy!

W razie pytań: PL_ZAKUPY@DAVITA.COM

